




Spécification de produit

Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 50 ml, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister

Page 1

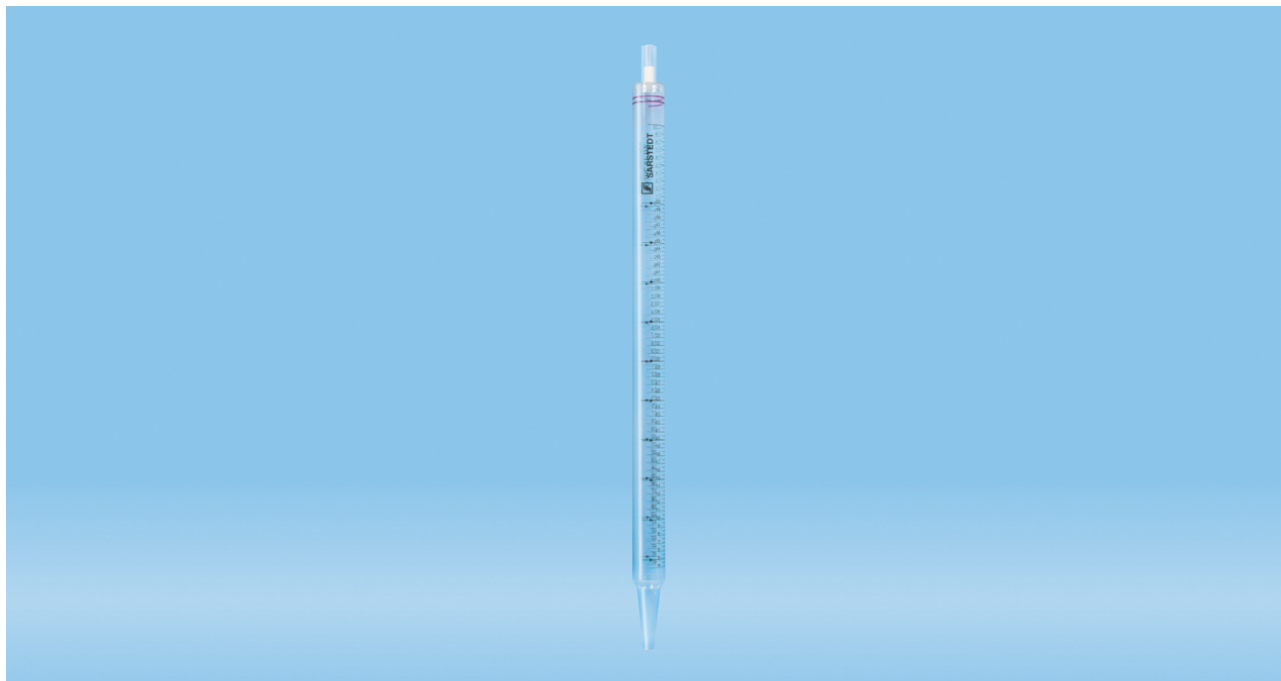

Description d'article

Numéro de commande	86.1256.001
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 50 ml, code couleur : violet, matériau : PS, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	violet/noir
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	4 ml - 60 ml
Couleur de codage	violet

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 50 ml,
stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non
cytotoxique, 1 pièce(s)/blister**

Page 2

Dimensions

Volume nominal	50 ml
Diamètre	18 mm
Longueur du produit	346.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	90
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	30
pièces / carton	90
pièces / pallet	6300
Profondeur du carton	312 mm
Largeur du carton	149 mm
Hauteur du carton	409 mm
Volume du carton	0.019 cbm
Poids du produit	0.0204 kg
Poids du carton	2.46 kg
Code EAN de la boîte	4038917394956
Code EAN du carton d'emballage	4038917394949

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT