




Spécification de produit
Pointe de pipette, 250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
pièce(s)/StackPack

Page 1

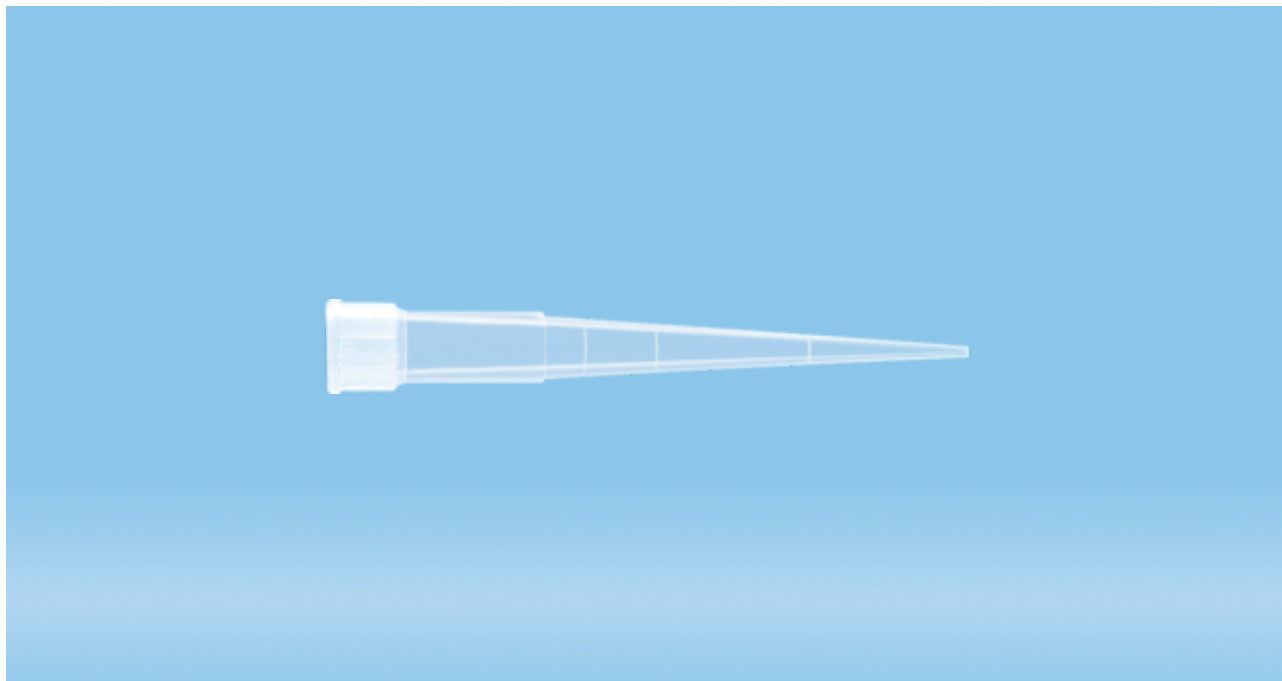

Description d'article

Numéro de commande	70.3031.110
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pointe de pipette, 250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
pièce(s)/StackPack

Page 2

Dimensions

Volume max.	250 µl
Longueur du produit	51 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	StackPack
pièces / boîte	1920
pièces / carton	1920
pièces / pallet	291840
Profondeur du carton	290 mm
Largeur du carton	157 mm
Hauteur du carton	225 mm
Volume du carton	0.0102 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	1.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917845533
Code EAN du carton	4038917845540
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT